

**Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1**  
**Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1**

Seite 1 / 2  
 Page

Kunde: **Mustermann AG**  
 Customer: **Musterstraße 10**  
**12345 Musterstadt**

Zeugnis-Nr. **01342114**  
 Certificate No.

Datum **13.01.2014**  
 Date

Kundenbestellnummer **B1315915**  
 Customer Order No.

Kunden Artikel-Nr. **7335508**  
 Customer Part. No.

Bestelldatum **17.12.2013**  
 Order Date

Auftrags-Nr. / Pos. **21257075/10**  
 Order No. / Item

Artikel-Nr. **7335508**  
 Part No.

Typ **Master CPH6200/CPT6200**  
 Model

Seriennummer **345/1105P5TF**  
 Serial number

Anzeigebereich **0 ... 100 bar rel.**  
 Scale range

Klasse **0,2% FS**  
 Class

Messstellen-Nr. **0 ... 100 bar rel.**  
 Tag No.


Referenzgerät **CPC8000 0,008% v. MW min. 4 mbar 0 ... 210 bar rel.**  
 Reference

Kalibriernummer **D16623**  
 Calibration No.

Ergebnis **23°C +/- 1 K**  
 Result

Temperatur **23°C +/- 1 K**  
 Temperature

Referenz Standard bar	Prüfung Test Item bar		rel. Abweichung rel. Deviation %	
	↑	↓	↑	↓
0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
12,50	12,5	12,5	0,00	0,00
25,00	25,0	25,0	0,00	0,00
37,50	37,5	37,5	0,00	0,00
50,00	50,0	50,0	0,00	0,00
62,50	62,5	62,5	0,00	0,00
75,00	75,0	75,0	0,00	0,00
87,50	87,4	87,4	-0,10	-0,10
100,00	99,9	99,9	-0,10	-0,10

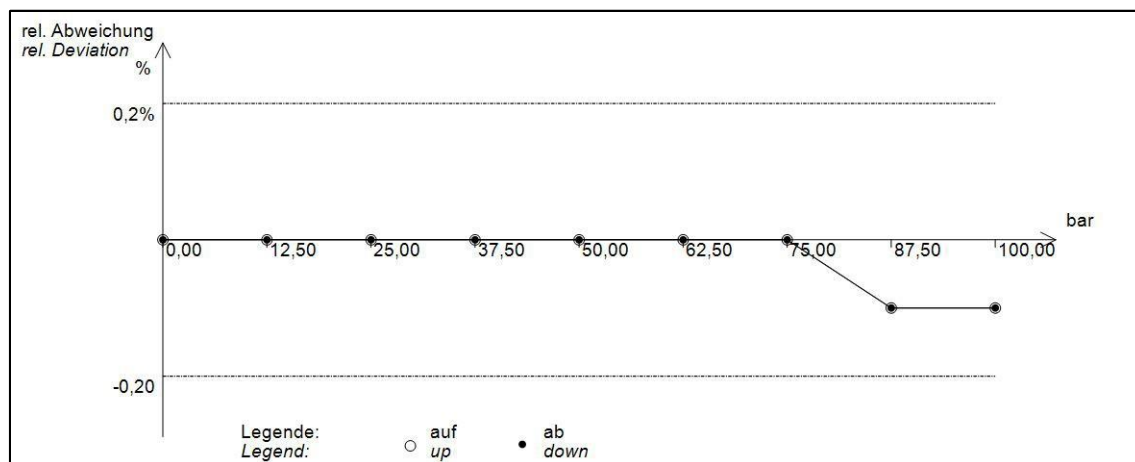

**Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 – 3.1**  
**Inspection certificate according to EN 10204 – 3.1**

Kunde: **Mustermann AG**  
Customer: **Musterstraße 10**  
**12345 Musterstadt**

Seite **2 / 2**  
Page

Zeugnis-Nr. **01342114**  
Certificate No.

Datum **13.01.2014**  
Date

---

**Der Kalibriergegenstand hält die Fehlergrenzen nach Herstellerangaben ein.**  
**Object keeps the specification.**

Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm: **IEC 61298**  
*Calibration was carried out according to the following norm:*

Bemerkung / Remarks:

Abnahmebeauftragter  
*Inspection Representative*

(MP-CT)  
**S. Muster**



113

Prüfer  
*Examiner*

**M. Mustermann**

Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift.  
*This document was created automatically and needs no signature.*